

ПАСПОРТ № 2434149

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект 4	Номер серии:	2434149	Кол-во наборов:	60
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	19.09.2024	Срок годности:	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	2434149l	19.09.24	19.03.25	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	2434149n	19.09.24	19.03.25	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	2434149h	19.09.24	19.03.25	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3.10	4,0 - 12,0	6.60	8,0 - 25,0	15.3
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	3.03	3,00 - 5,00	4.06	4,00 - 6,00	5.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	71	100 - 300	181	200 - 600	443


Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

О.Г. Веленца

Дата выдачи паспорта

19.09.2024

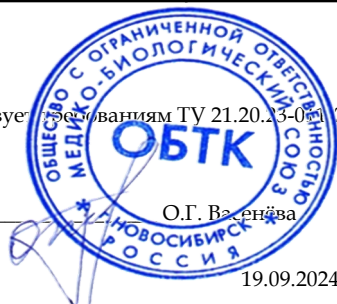

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-3600	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.10 ± 1.00		6.80 ± 2.00		15.50 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	46.0 ± 15.0		27.0 ± 15.0		54.0 ± 15.0	
		0.46 ± 0.15		0.27 ± 0.15		0.54 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	14.0 ± 14.0		9.0 ± 9.0		12.0 ± 12.0	
		0.14 ± 0.14		0.09 ± 0.09		0.12 ± 0.12	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	40.6 ± 15.0		64.8 ± 15.0		35.8 ± 15.0	
		0.41 ± 0.15		0.65 ± 0.15		0.36 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.40 ± 0.50		1.80 ± 1.00		8.40 ± 2.30	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40		0.60 ± 0.60		1.90 ± 1.90	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.30 ± 0.50		4.40 ± 1.00		5.60 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30		4.10 ± 0.45		5.00 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.0 ± 1.0		11.5 ± 1.0		15.8 ± 1.0	
	g/L	80 ± 10		115 ± 10		158 ± 10	
	mmol/L	5.0 ± 0.7		7.2 ± 0.7		9.9 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	27.0 ± 7.5		37.0 ± 10.0		49.0 ± 10.0	
	L/L	0.27 ± 0.08		0.37 ± 0.10		0.49 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	80.3 ± 12.0		84.3 ± 12.0		93.2 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0		29.0 ± 7.0		32.0 ± 7.0	
	fmol	1.7 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0	
	g/L	340 ± 70		340 ± 70		340 ± 70	
	mmol/L	21.2 ± 4.4		21.2 ± 4.4		21.2 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.4 ± 5.0		15.0 ± 5.0		14.0 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	37.9 ± 10.0		38.8 ± 10.0		41.5 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	70 ± 35		184 ± 55		444 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	8.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0		16.0 ± 3.0		20.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05		0.12 ± 0.08		0.29 ± 0.10	
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	12.0 ± 6.0		22.0 ± 11.0		45.0 ± 22.5	
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	18.0 ± 9.0		12.0 ± 6.0		10.2 ± 5.1	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ И. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-2800/BC-3000+/BC-3200	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.10 ± 1.00		6.80 ± 2.00		15.10 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	46.0 ± 15.0		27.0 ± 15.0		53.0 ± 15.0	
		0.46 ± 0.15		0.27 ± 0.15		0.53 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	12.0 ± 12.0		8.0 ± 8.0		12.0 ± 12.0	
		0.12 ± 0.12		0.08 ± 0.08		0.12 ± 0.12	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	42.8 ± 15.0		66.4 ± 15.0		36.0 ± 15.0	
		0.43 ± 0.15		0.66 ± 0.15		0.36 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.40 ± 0.50		1.80 ± 1.00		8.00 ± 2.30	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40		0.50 ± 0.50		1.80 ± 1.80	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.30 ± 0.50		4.50 ± 1.00		5.40 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30		4.00 ± 0.45		4.90 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.9 ± 1.0		11.5 ± 1.0		15.6 ± 1.0	
	g/L	79 ± 10		115 ± 10		156 ± 10	
	mmol/L	5.0 ± 0.7		7.2 ± 0.7		9.7 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	25.0 ± 7.5		36.0 ± 10.0		48.0 ± 10.0	
	L/L	0.25 ± 0.08		0.36 ± 0.10		0.48 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.3 ± 12.0		84.7 ± 12.0		94.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.9 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0	
	g/L	360 ± 70		350 ± 70		350 ± 70	
	mmol/L	22.4 ± 4.4		21.8 ± 4.4		21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0		14.0 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	38.1 ± 10.0		40.5 ± 10.0		43.2 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	50 ± 35		180 ± 55		430 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.5 ± 3.0		6.5 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0		15.5 ± 3.0		15.5 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04		0.11 ± 0.08		0.27 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-30s	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.00 ± 1.00		6.80 ± 2.00		14.80 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	46.0 ± 15.0		27.0 ± 15.0		53.0 ± 15.0	
		0.46 ± 0.15		0.27 ± 0.15		0.53 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	10.0 ± 10.0		6.0 ± 6.0		12.0 ± 12.0	
		0.10 ± 0.10		0.06 ± 0.06		0.12 ± 0.12	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	45.0 ± 15.0		67.9 ± 15.0		36.5 ± 15.0	
		0.45 ± 0.15		0.68 ± 0.15		0.36 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.40 ± 0.50		1.80 ± 1.00		7.80 ± 2.20	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.40 ± 0.40		1.80 ± 1.80	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.40 ± 0.50		4.60 ± 1.00		5.40 ± 2.20	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.70 ± 0.30		3.90 ± 0.45		4.70 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.8 ± 1.0		11.5 ± 1.0		15.3 ± 1.0	
	g/L	78 ± 10		115 ± 10		153 ± 10	
	mmol/L	4.9 ± 0.7		7.2 ± 0.7		9.6 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5		35.0 ± 10.0		47.0 ± 10.0	
	L/L	0.23 ± 0.08		0.35 ± 0.10		0.47 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.3 ± 12.0		85.1 ± 12.0		94.7 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.9 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	38.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0	
	g/L	380 ± 70		360 ± 70		350 ± 70	
	mmol/L	23.6 ± 4.4		22.4 ± 4.4		21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0		14.0 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	38.5 ± 10.0		42.2 ± 10.0		45.1 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	56 ± 35		173 ± 55		431 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	17.0 ± 3.0		16.0 ± 3.0		16.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04		0.11 ± 0.08		0.26 ± 0.10	
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	7.0 ± 3.5		13.0 ± 6.5		29.0 ± 14.5	
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	12.1 ± 6.0		7.3 ± 3.7		6.6 ± 3.3	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ И.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годеи до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.00 ± 1.00		6.70 ± 2.00		15.10 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	44.0 ± 15.0		25.8 ± 15.0		52.4 ± 15.0	
		0.44 ± 0.15		0.26 ± 0.15		0.52 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	15.9 ± 15.0		9.0 ± 9.0		11.9 ± 11.9	
		0.16 ± 0.15		0.09 ± 0.09		0.12 ± 0.12	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	40.1 ± 15.0		65.2 ± 15.0		35.7 ± 15.0	
		0.40 ± 0.15		0.65 ± 0.15		0.36 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.30 ± 0.50		1.70 ± 1.00		7.90 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.50 ± 0.50		0.60 ± 0.60		1.80 ± 1.80	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50		4.40 ± 1.00		5.40 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30		4.00 ± 0.45		4.90 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.8 ± 1.0		11.7 ± 1.0		15.6 ± 1.0	
	g/L	78 ± 10		117 ± 10		156 ± 10	
	mmol/L	4.9 ± 0.7		7.3 ± 0.7		9.7 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5		33.0 ± 10.0		45.0 ± 10.0	
	L/L	0.23 ± 0.08		0.33 ± 0.10		0.45 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	77.5 ± 12.0		83.2 ± 12.0		91.9 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.8 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0	
	g/L	360 ± 70		360 ± 70		350 ± 70	
	mmol/L	22.4 ± 4.4		22.4 ± 4.4		21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.1 ± 5.0		15.2 ± 5.0		14.8 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	35.1 ± 5.0		38.2 ± 5.0		40.6 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	56 ± 35		172 ± 55		442 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	8.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	12.0 ± 3.0		11.3 ± 3.0		11.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.050 ± 0.050		0.114 ± 0.080		0.283 ± 0.100	
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	11.0 ± 5.5		8.0 ± 4.0		7.0 ± 3.5	
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	7.00 ± 3.50		13.00 ± 6.50		27.00 ± 13.50	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.00 ± 0.50		6.50 ± 1.00		14.80 ± 2.50
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%		%	42.8 ± 15.0		25.1 ± 15.0		51.5 ± 15.0
			0.43 ± 0.15		0.25 ± 0.15		0.52 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%		%	17.4 ± 9.0		9.1 ± 9.0		12.6 ± 9.0
			0.17 ± 0.09		0.09 ± 0.09		0.13 ± 0.09
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%		%	39.8 ± 15.0		65.8 ± 15.0		35.9 ± 15.0
			0.40 ± 0.15		0.66 ± 0.15		0.36 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#		10 ⁹ /L	1.30 ± 0.50		1.60 ± 1.00		7.60 ± 2.20
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#		10 ⁹ /L	0.50 ± 0.30		0.60 ± 0.60		1.90 ± 1.30
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#		10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50		4.30 ± 1.00		5.30 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	2.70 ± 0.15		3.90 ± 0.20		4.80 ± 0.30
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	7.5 ± 0.5		11.8 ± 0.5		15.4 ± 0.5
		g/L	75 ± 5		118 ± 5		154 ± 5
		mmol/L	4.7 ± 0.4		7.4 ± 0.4		9.6 ± 0.4
Гематокрит, HCT		%	20.5 ± 3.0		32.0 ± 3.0		43.5 ± 3.0
		L/L	0.21 ± 0.03		0.32 ± 0.03		0.44 ± 0.03
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	74.5 ± 5.0		82.0 ± 5.0		90.5 ± 5.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.5 ± 3.0		30.0 ± 3.0		32.0 ± 3.0
		fmol	1.8 ± 0.2		1.9 ± 0.2		2.0 ± 0.2
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	37.0 ± 4.0		36.5 ± 4.0		35.5 ± 4.0
		g/L	370 ± 40		365 ± 40		355 ± 40
		mmol/L	23.0 ± 2.5		22.7 ± 2.5		22.1 ± 2.5
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	15.5 ± 3.0		16.0 ± 5.0		15.5 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	32.5 ± 5.0		37.5 ± 5.0		40.0 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	58 ± 25		177 ± 45		457 ± 60
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	7.0 ± 3.0		6.5 ± 3.0		6.5 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		%	8.5 ± 3.0		7.5 ± 3.0		7.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.040 ± 0.020		0.120 ± 0.070		0.280 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	3.5 ± 3.5		2.0 ± 2.0		1.5 ± 1.5
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	2.0 ± 1.6		3.5 ± 2.8		8.0 ± 6.4

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Medonic M-20	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.00 ± 1.00		6.90 ± 2.00		15.10 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	40.0 ± 15.0		23.0 ± 15.0		49.0 ± 15.0	
		0.40 ± 0.15		0.23 ± 0.15		0.49 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	9.0 ± 9.0		6.0 ± 6.0		8.0 ± 8.0	
		0.09 ± 0.09		0.06 ± 0.06		0.08 ± 0.08	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	51.4 ± 15.0		72.0 ± 15.0		43.7 ± 15.0	
		0.51 ± 0.15		0.72 ± 0.15		0.44 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50		1.60 ± 1.00		7.40 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.40 ± 0.40		1.20 ± 1.20	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		5.00 ± 1.00		6.60 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.70 ± 0.30		3.90 ± 0.45		4.90 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.9 ± 1.0		11.8 ± 1.0		16.0 ± 1.0	
	g/L	79 ± 10		118 ± 10		160 ± 10	
	mmol/L	5.0 ± 0.7		7.4 ± 0.7		10.0 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5		34.0 ± 10.0		47.0 ± 10.0	
	L/L	0.23 ± 0.08		0.34 ± 0.10		0.47 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	74.9 ± 12.0		81.0 ± 12.0		90.9 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	40.0 ± 7.0		38.0 ± 7.0		37.0 ± 7.0	
	g/L	400 ± 70		380 ± 70		370 ± 70	
	mmol/L	24.9 ± 4.4		23.6 ± 4.4		23.0 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.4 ± 5.0		12.8 ± 5.0		12.8 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	51 ± 35		163 ± 55		404 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.034 ± 0.034		0.093 ± 0.080		0.222 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Swelab Alfa	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.00 ± 1.00		6.90 ± 2.00		15.10 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	39.9 ± 15.0		22.2 ± 15.0		48.1 ± 15.0	
		0.40 ± 0.15		0.22 ± 0.15		0.48 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.7 ± 8.7		5.8 ± 5.8		8.2 ± 8.2	
		0.09 ± 0.09		0.06 ± 0.06		0.08 ± 0.08	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	51.4 ± 15.0		72.0 ± 15.0		43.7 ± 15.0	
		0.51 ± 0.15		0.72 ± 0.15		0.44 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50		1.50 ± 1.00		7.30 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.40 ± 0.40		1.20 ± 1.20	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		5.00 ± 1.00		6.60 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.70 ± 0.30		3.90 ± 0.45		4.90 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.9 ± 1.0		11.8 ± 1.0		16.0 ± 1.0	
	g/L	79 ± 10		118 ± 10		160 ± 10	
	mmol/L	5.0 ± 0.7		7.4 ± 0.7		10.0 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	21.0 ± 7.5		32.0 ± 10.0		45.0 ± 10.0	
	L/L	0.21 ± 0.08		0.32 ± 0.10		0.45 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	74.9 ± 12.0		81.0 ± 12.0		90.9 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	40.0 ± 7.0		38.0 ± 7.0		37.0 ± 7.0	
	g/L	400 ± 70		380 ± 70		370 ± 70	
	mmol/L	24.9 ± 4.4		23.6 ± 4.4		23.0 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.4 ± 5.0		12.8 ± 5.0		12.8 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	51 ± 35		155 ± 55		396 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.030 ± 0.030		0.089 ± 0.080		0.218 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.10 ± 1.00		6.80 ± 2.00		15.10 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	43.0 ± 15.0		25.0 ± 15.0		51.0 ± 15.0	
		0.43 ± 0.15		0.25 ± 0.15		0.51 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	13.0 ± 9.0		7.0 ± 7.0		11.0 ± 9.0	
		0.13 ± 0.09		0.07 ± 0.07		0.11 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	44.0 ± 15.0		68.0 ± 15.0		38.0 ± 15.0	
		0.44 ± 0.15		0.68 ± 0.15		0.38 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.30 ± 0.50		1.70 ± 1.00		7.70 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.30		0.50 ± 0.50		1.70 ± 1.40	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.40 ± 0.50		4.60 ± 1.00		5.70 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.80 ± 0.30		4.00 ± 0.45		4.90 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.8 ± 1.0		11.7 ± 1.0		15.7 ± 1.0	
	g/L	78 ± 10		117 ± 10		157 ± 10	
	mmol/L	4.9 ± 0.7		7.3 ± 0.7		9.8 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	22.0 ± 7.5		33.0 ± 10.0		45.0 ± 10.0	
	L/L	0.22 ± 0.08		0.33 ± 0.10		0.45 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	77.0 ± 12.0		83.0 ± 12.0		92.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.9 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0	
	g/L	370 ± 70		360 ± 70		360 ± 70	
	mmol/L	23.0 ± 4.4		22.4 ± 4.4		22.4 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.2 ± 5.0		14.5 ± 5.0		14.1 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	58 ± 35		173 ± 55		433 ± 115	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	8.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	13.4 ± 3.0		11.7 ± 3.0		11.5 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.041 ± 0.041		0.109 ± 0.080		0.265 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434149	Дата выпуска	19.09.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	19.03.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Drew D3	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.20 ± 1.00		6.65 ± 2.00		15.10 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%	42.4 ± 15.0		22.0 ± 15.0		39.2 ± 15.0	
		0.42 ± 0.15		0.22 ± 0.15		0.39 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%	10.5 ± 9.0		7.5 ± 7.5		12.8 ± 9.0	
		0.11 ± 0.09		0.07 ± 0.08		0.13 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, GRA%	%	47.1 ± 15.0		70.6 ± 15.0		48.0 ± 15.0	
		0.47 ± 0.15		0.71 ± 0.15		0.48 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L	1.35 ± 0.50		1.45 ± 1.00		5.90 ± 2.25	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L	0.35 ± 0.30		0.50 ± 0.50		1.95 ± 1.35	
Абс. кол-во гранулоцитов, GRA#	10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		4.70 ± 1.00		7.25 ± 2.25	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.80 ± 0.30		3.95 ± 0.45		4.90 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.5 ± 1.0		11.9 ± 1.0		15.3 ± 1.0	
	g/L	75 ± 10		119 ± 10		153 ± 10	
	mmol/L	4.7 ± 0.7		7.4 ± 0.7		9.6 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	21.1 ± 7.5		31.5 ± 10.0		44.1 ± 10.0	
	L/L	0.21 ± 0.08		0.32 ± 0.10		0.44 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	75.4 ± 12.0		79.7 ± 12.0		90.1 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.8 ± 7.0		30.1 ± 7.0		31.2 ± 7.0	
	fmol	1.7 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.5 ± 7.0		38.0 ± 7.0		34.5 ± 7.0	
	g/L	355 ± 70		380 ± 70		345 ± 70	
	mmol/L	22.1 ± 4.4		23.6 ± 4.4		21.5 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему, RDW	%	13.8 ± 5.0		14.0 ± 5.0		14.1 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	75 ± 35		210 ± 55		495 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.050 ± 0.050		0.120 ± 0.080		0.320 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва